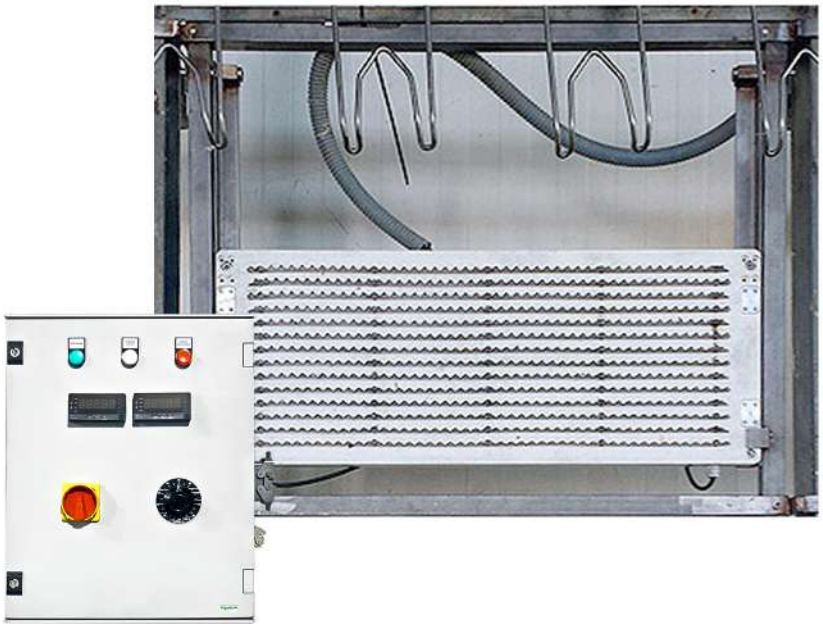

ANESTHÉSIE À "GRILLE" POUR LAPINS

MOD. ATP-001

Anesthésie électronique à grille - Prod. Max. : 1 800 lapins/h

La machine est conforme aux normes CE

Tableau électronique avec affichage numérique de la tension et de l'intensité, réglage de l'anesthésie, 0 à 200 V (en option version 0 à 400 V), voyant de tension d'entrée du courant.
Transformateur sur bobines séparées.
Électrodes échangeables sur la grille.
Emplacement in-situ dans vos installations.
Les électrodes ne s'activent qu'au moment du placement du lapin, très important pour éviter les accidents de travail.
Voyant confirmant que le processus d'électronarcose est correct.
Possibilité de relier notre ENREGISTREUR de paramètres d'anesthésie. (*)

Machine en acier inoxydable à polissage électrolytique. Poids d'env. : 45 kg

---

(*) Conformément au règlement CE, à compter de janvier 2013, les nouveaux abattoirs doivent respecter ce qui suit (annexe II du règlement 1099/2009) : le matériel d'anesthésie doit être doté d'un système qui enregistre les paramètres d'étourdissement, qui seront conservés pendant un an.
Pour ce qui concerne le reste des abattoirs, la réglementation entrera en vigueur le 8 décembre 2019.

MEVIR S.A.
Portugal, 3 - Pol.Ind.Les Comes | 08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 938 030 649 | mevirsa@mevirsa.com
www.mevirsa.com